


PHIẾU THEO DÕI NHIỆT ĐỘ TỦ LƯU TRỮ HUYẾT TƯƠNG

Phòng: Miễn dịch và Truyền máu Tháng:..... Năm 201...

Khoảng chấp nhận: -18°C đến -30°C

Thời gian ghi nhiệt độ: 8 giờ sáng

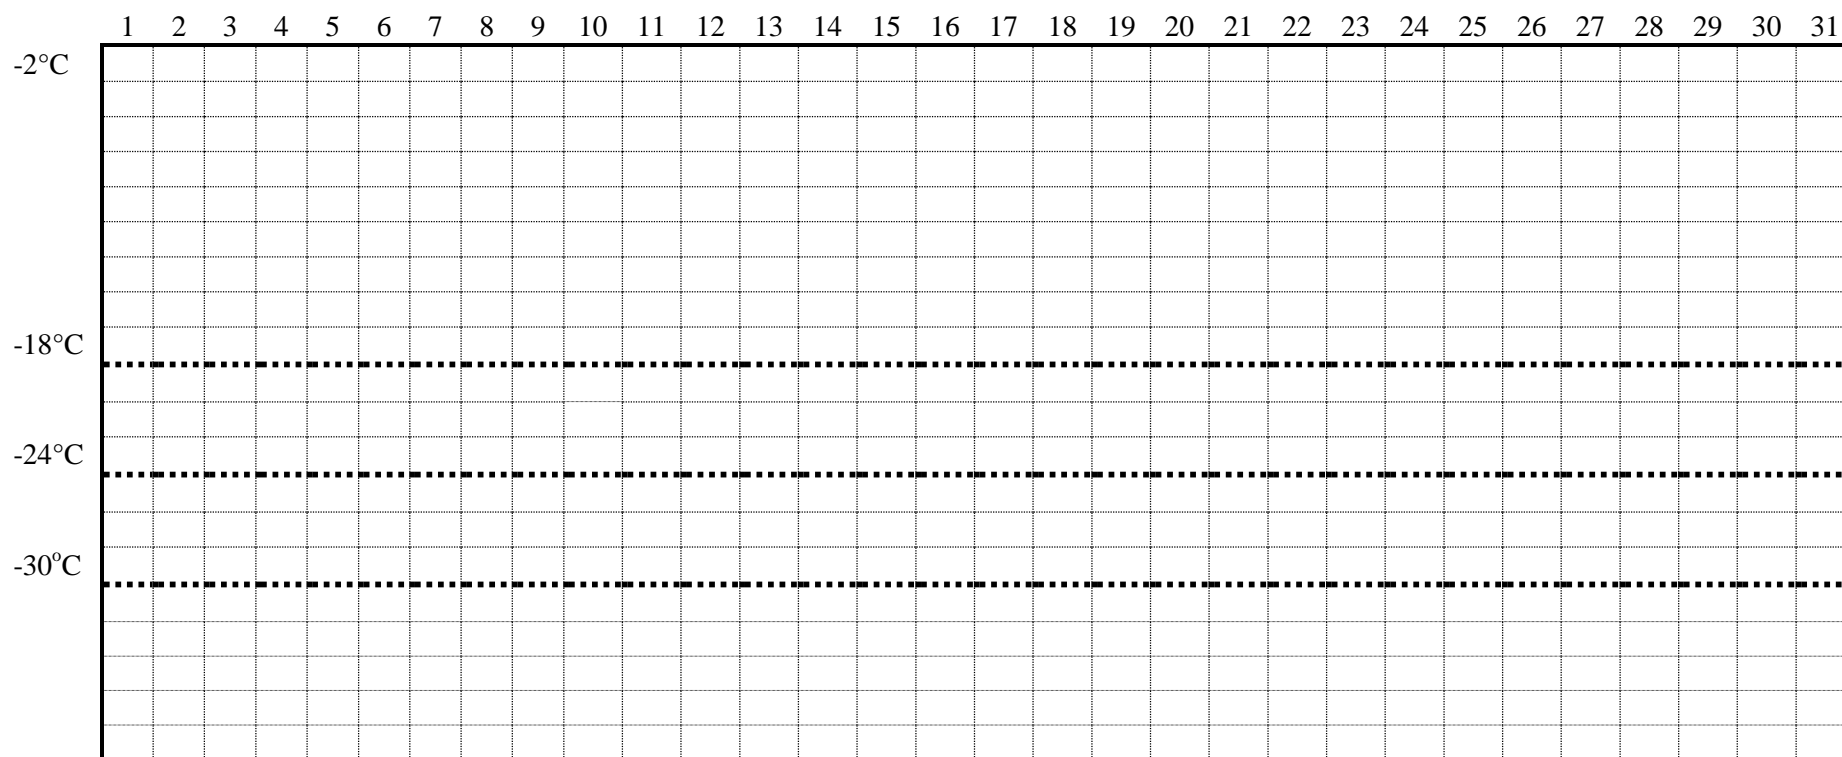

PHỤ TRÁCH THIẾT BỊ

Phiên bản:3.0

Ngày ban hành:20/07/2016